達人プラス
TATSUJIN PLUS

Assist
アシスト

設定マニュアル

本マニュアルは達人プラス Assist の設定用マニュアルです。
操作方法の確認につきましては別紙の操作マニュアルをご参照下さい。
設定にあたり弊社発行の認証番号が必要となります。
認証番号発行までの流れにつきましては本マニュアル内の「はじめに」をご覧下さい。

NARCOHM
ナルコーム

目　次

● はじめに	1 ページ
● 動作環境及び注意事項	2 ページ
● 達人プラスのバージョンを確認する	3 ページ
● 達人プラスのアップデート	3 ページ
● 達人プラス Assist の登録	4 ページ
● 達人プラスコンピュータ側の設定	5 ページ
● 達人プラス Assist の端末設定	8 ページ

はじめに（必ず最初にご確認下さい）

達人プラス Assist をご購入頂き、誠にありがとうございます。

必ず最初にご利用手順をご確認下さい。

※達人プラスをご利用のコンピュータのいずれか１台はインターネットに接続する必要があります。

① 達人プラス Assist 申込書をご記入下さい。

同封の達人プラス Assist 申込書にご記入の上弊社まで FAX でご送付下さい。

弊社より FAX にてプロダクト ID をご返信致します。

↓

② 達人プラスのバージョンを確認する

バージョンをご確認後、必要に応じてアップデートを行って下さい。(3 ページ)

↓

③ プロダクト ID の登録を行う

達人プラス親機のコンピュータ側に達人プラス Assist を使用する設定を行って下さい。(4 ページ)

↓

④ 達人プラスのコンピュータ側の設定を行う

達人プラスがインストールされている親機と子機に設定が必要です。(5 ページ)

↓

⑤ 達人プラス Assist の端末設定を行う

院内の無線に端末を接続し、達人プラス親機に接続後利用開始となります。(8 ページ)

＜達人プラス Assist のインストールは下記 QR コードからインストールが可能です＞

【動作環境】

●達人プラス Assist の登録を行うコンピュータ（達人プラス親機）

Windows10 Pro 64bit 版
Windows11 Pro 64bit 版
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
※Server Core は対象外となります。
※32 ビットは対象外となります。

●達人プラス Assist のライセンス確認を行うコンピュータ
（達人プラスをご利用のコンピュータのいずれか 1 台）

インターネット接続可能な Microsoft 社サポート期間中の WindowsOS
（2025 年 4 月現在は Windows10 でも可能ですが、2025 年 10 月 14 日以降は Windows11 以上となります）

●達人プラス Assist

- iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini の場合は AppStore よりダウンロード及びインストールが出来るバージョンでご利用いただけます。
- iPhone ではご利用頂けません。
- Android ではご利用頂けません。


※ デジタルペンをご利用の場合は、純正の Apple Pencil でのご利用を推奨しております。
純正ペンではない場合や、iPad の世代に合っていないペンをご利用の場合動きがスムーズではないなど個体差が出る可能性があります。

【注意事項】

- 本製品は、達人プラスのオプション製品となりますので達人プラスが無いと使用できません。
- 達人プラスのバージョンは最新版へのアップデートが必要です。
- 達人プラス Version1、2、3、4、5 ではご利用頂けません。
- 達人プラス Assist をインストールまたは更新するには、インターネットに接続し App Store からダウンロードが必要です。
- 製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPhone, iOS, App Store は、Apple Inc. の商標です。
Windows, Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

達人プラスのバージョンを確認する

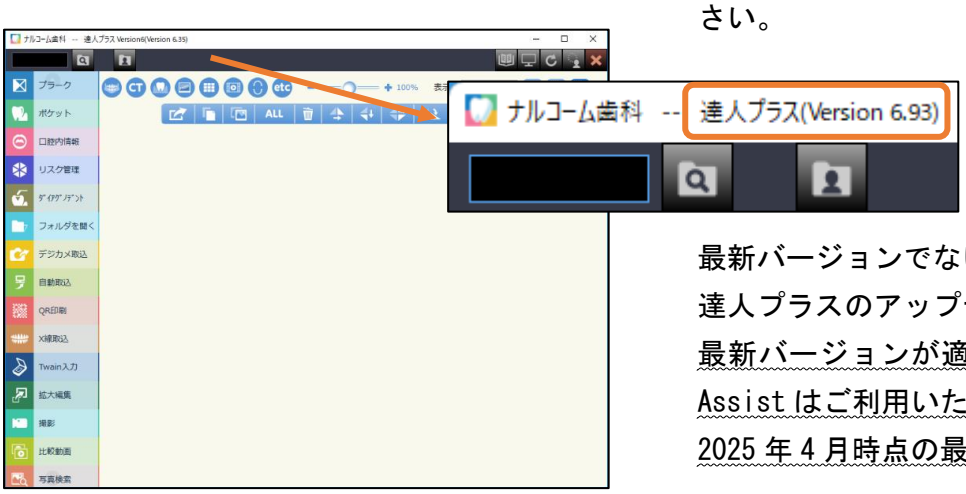


達人プラスを起動しバージョンの確認を行って下さい。

最新バージョンでない場合は、次の案内に沿って達人プラスのアップデートを行って下さい。
最新バージョンが適用出来ない場合、達人プラス Assist はご利用いただけません。
2025 年 4 月時点の最新バージョンは 6.93 です。

最新バージョンの場合は
達人プラス Assist の登録へ進んで下さい。

最新バージョンは常に弊社ホームページより
ご確認いただけます。https://www.narcohm.co.jp/

達人プラスのアップデート

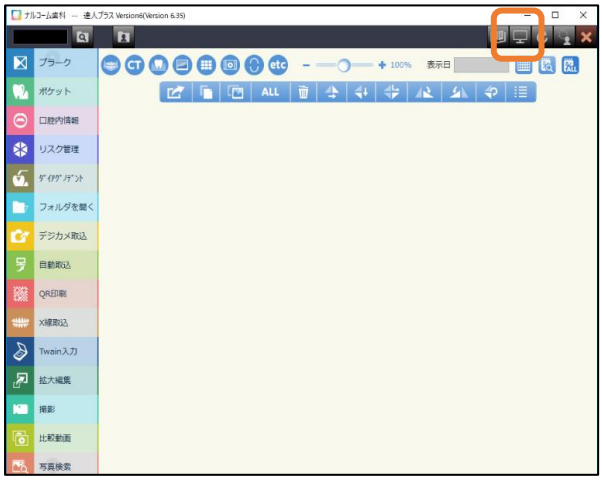


1．達人プラスを起動し画面右上の  より
達人プラスのホームページにアクセスして下さい。



2．アップデートプログラムから現在のバージョンにあったプログラムをダウンロードして下さい。


ダウンロード頂いた中にアップデートの手順書もございますのでご確認頂きますようお願い致します。
※正しいプログラムを適用頂かないと再インストールが必要になることがあります。

達人プラス Assist の登録

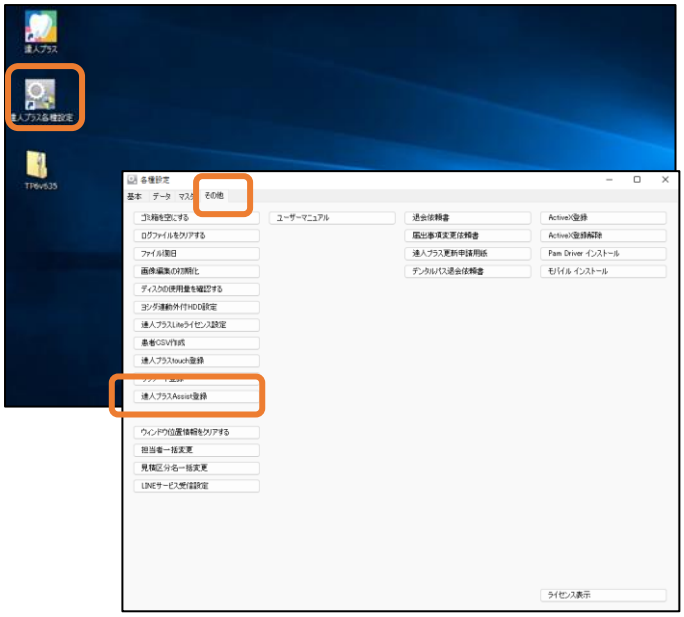


1．**達人プラス（コンピュータ側）の親機**で達人プラス各種設定を起動して下さい。

2．その他タブ内、達人プラス Assist 登録をクリックし、プロダクト ID を入力後、登録をクリックしてください。

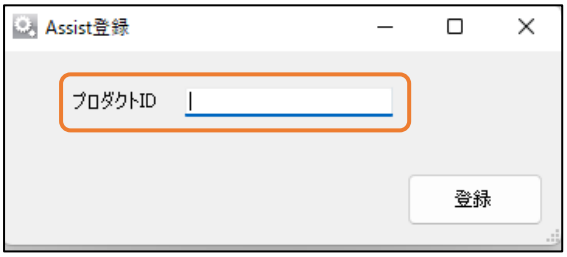

3．弊社よりご案内しておりますコードを入力し登録をクリックして下さい。

※動作環境外のコンピュータの場合はエラーメッセージが表示されます。P.2【動作環境】をご確認の上、対象のコンピュータで設定を行って下さい。

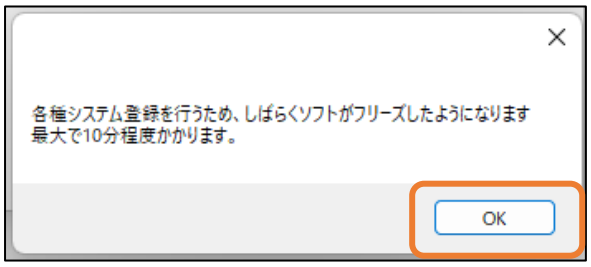

4．OK をクリックして下さい。



5．黒い背景の画面が出ましたら画面が閉じるまでお待ちください。登録しましたの表示が出ましたら OK をクリックして下さい。


達人プラスコンピュータ側の設定



1．**達人プラス（コンピュータ側）の親機**で達人プラス各種設定を起動して下さい。




2．達人プラス各種設定の基本タブより印刷設定をクリックして下さい。

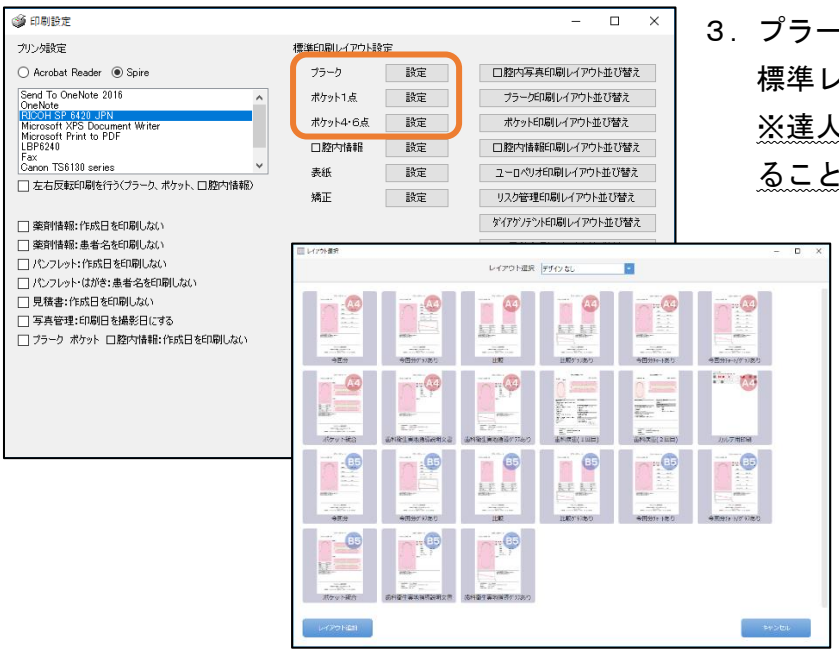

3．プラーク、ポケット１点、ポケット４，６点の標準レイアウトを選択して下さい。
※達人プラス Assist 側でレイアウトを選択することは出来ません。予めご選択下さい。




4．写真管理設定をクリックして下さい。

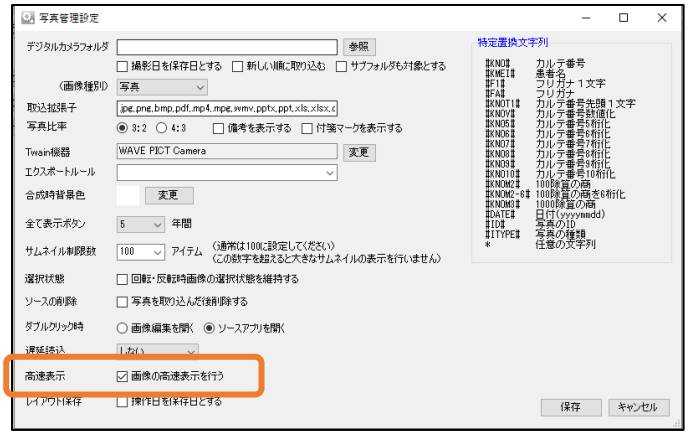


5．画像の高速表示を行うにチェックを入れ、保存をクリックして下さい。

５の設定は達人プラスがインストールされている全てのコンピュータに行って下さい。

以前より達人プラスをお使いの医院様は下記の操作を、達人プラスの親機で行って下さい。
達人プラスのデータ量により時間がかかる場合がございます。

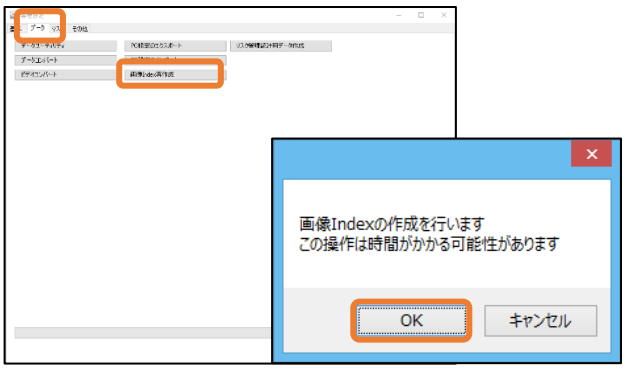

データタブを開き画像 Index 再作成をクリックして下さい。メッセージを確認し OK をクリックして下さい。

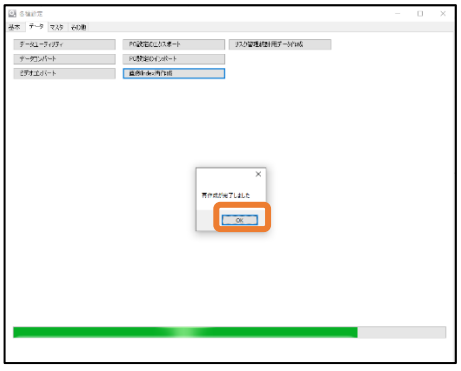

再作成が完了しましたのメッセージは OK をクリックして下さい。



6．基本設定をクリックして下さい。


※この設定は 2 ページに記載の「達人プラス Assist のライセンス確認を行うコンピュータ」で設定を行ってください。（院内で 1 台のみ）

- **サポート対象 OS であること**
- **インターネットに接続されていること**
- **達人プラスを使う頻度が高いこと**

上記と 2 ページ内を確認してください。
達人プラス親機でも子機でも上記を満たしていれば可能です。




7．インターネット接続機にチェックを入れ保存をクリックして下さい。

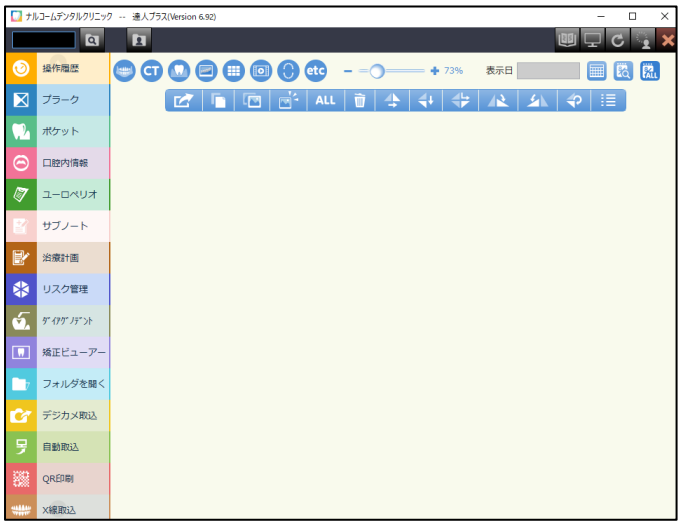

8．インターネット接続機の☑を入れたパソコンで達人プラスを起動してください。起動後 1 分程度お待ちください。

達人プラス Assist の端末設定

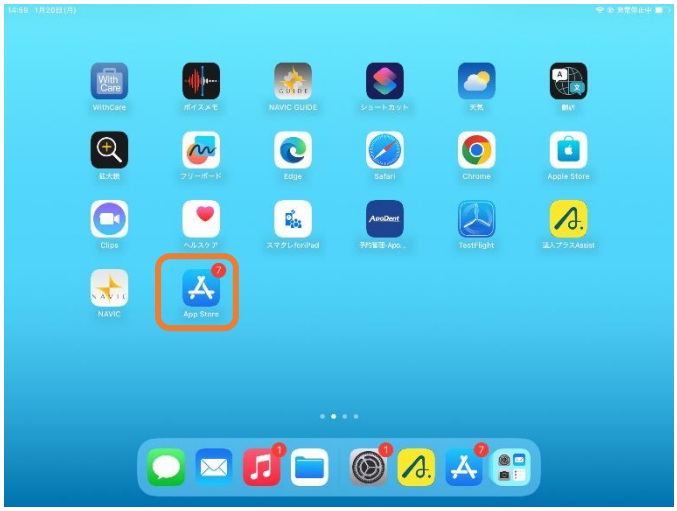

1．App Store より達人プラス Assist をインストールして下さい。
※達人プラス Assist で検索を行うか下記 QR コードよりダウンロード先へ移動して下さい。



2．インストール後、達人プラス親機のネットワークへ接続し、達人プラス Assist を起動して下さい。




3．設定を選択して下さい。

※同一ネットワーク内に達人プラスの親機が存在する必要があります。



4．親機の IP アドレスを入力して下さい。

※親機の達人プラス各種設定内、ステータス表示に親機の IP アドレスが記載されております。

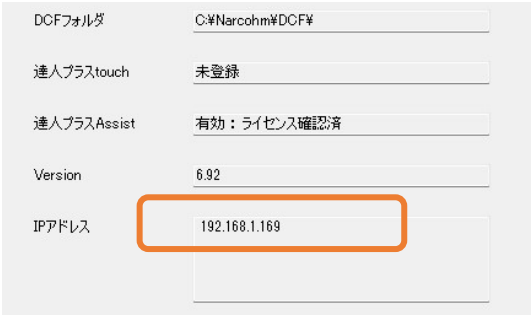





５．テストを選択し、【成功】表示が出ましたら保存をクリックして下さい。

操作方法につきましては
操作マニュアルをご参照ください。

＜その他設定の項目＞

OFF の状態 


ON の状態 



ペンシルモード　**（初期設定は OFF です）**


ペンを使用しない場合は OFF にしてください。iPad ペンシルをご利用の場合は ON にしてください。
ON に設定すると、手での操作と、ペンでの操作を端末が感知しますので手では画像を拡大し、ペンで書き込むために最適な設定となります。

＜ペンシルモードにすると＞
手とペンの動作を自動判別します。

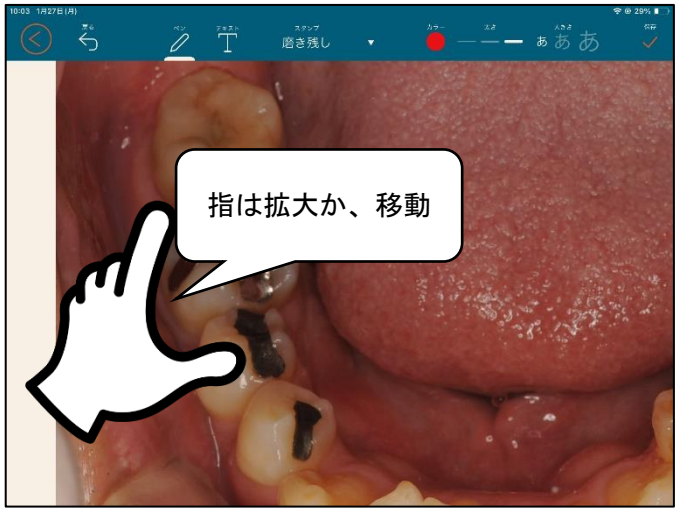




＜ペンシルモードオフの場合＞

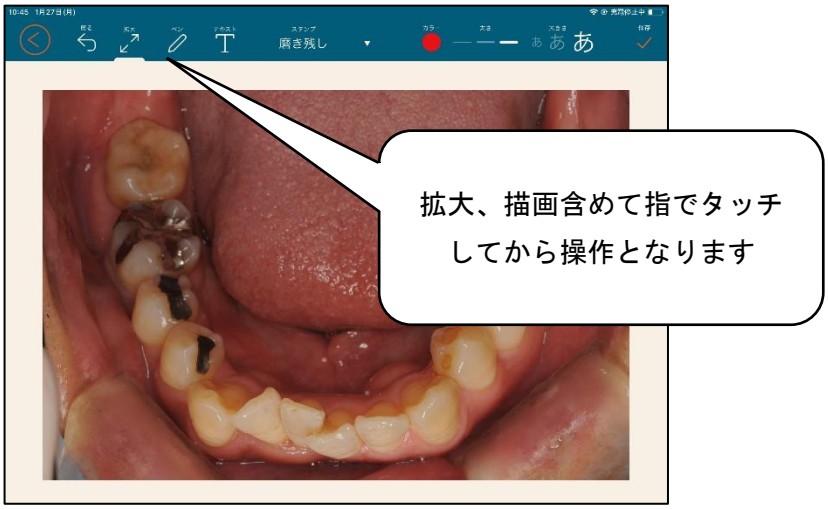

初期表示をALLにする（初期設定は ON です）

患者さんを呼び出し時に、毎回全てのデータを読み込むか本日のみとするかを設定できます。

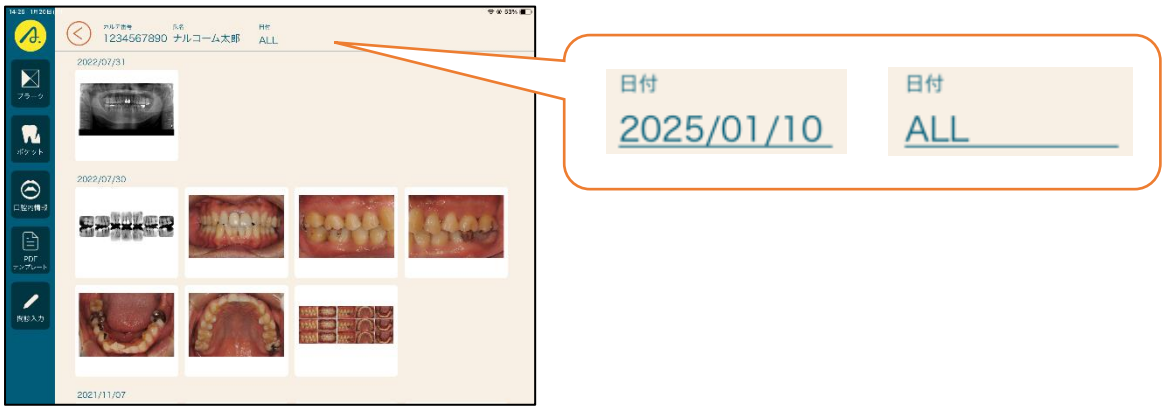


PDFの最終ページを開く（初期設定は OFF です）

PDF を開く際に複数枚に渡っている場合に、必ず最終ページを開いてくるように指定できます。

患者履歴を使用する（初期設定は OFF です）

訪問で使用する場合には、患者さんの情報を保持することが可能です。

ON にすると 患者履歴 ボタンがメイン画面に表示され、過去に呼び出された患者さんを選択でき、画面を開けます。

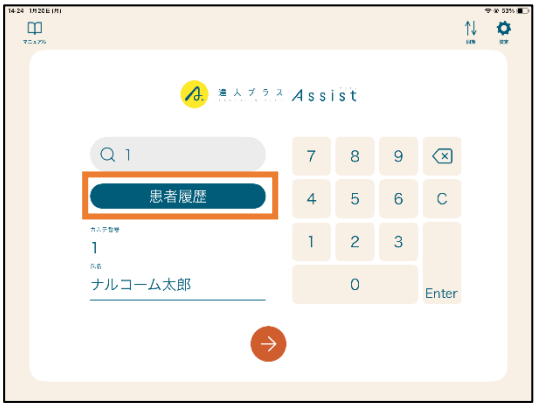

- ☑ カメラで新規追加する　右下 新規 を押した際、カメラを起動できるようにします。
- ☑ カメラロールで新規追加する　右下 新規 を押した際、カメラロールからの取込を可能にします。
- ☑ ファイルから選択で新規追加する　右下 新規 を押した際、ファイルから選択を可能にします。



